



Kraków, dnia 25 marca 2022 r.

AG.240.4.2022.BM

Modyfikacja SWZ nr 2
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę i instalację chromatografu cieczowego
ze spektrometrem masowym

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, iż wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 8:

„Dla większości aplikacji z wykorzystaniem LC-MS/MS zakres dynamiczny 5 rzędów wielkości jest wystarczającym dla zakresów terapeutycznych oznaczanych leków oraz aby spełnić wymagania w zakresie oznaczanych stężeń.

Czy w tej sytuacji Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem dynamicznym 5 rzędów wielkości?”

Odpowiedź 8:

Nie. Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania detektora o zakresie dynamicznym nie gorszym niż 6 rzędów.

Pytanie 9:

„Podczas większości analiz wykonywanych z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS zdecydowana większość oznaczanych związków analizowana jest w jonizacji dodatniej, a tylko niewielka liczba związków analizowana jest w jonizacji ujemnej. W tej sytuacji czas przełączenia polaryzacji 50 ms nie wypłynie negatywnie na ilość punktów pomiarowych na pikie chromatograficznym, szczególnie w przypadku zastosowania algorytmu typu scheduled MRM.

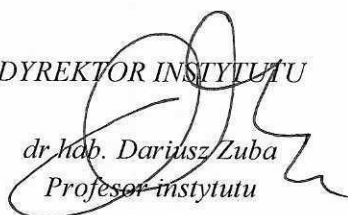
Zatem czy Zamawiający dopuści spektrometr z czasem zmiany polaryzacji 50 ms?”

Odpowiedź 9:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza spektrometru z czasem zmiany polaryzacji 50 ms.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jego zakres i charakter nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. Dariusz Zuba
Profesor instytutu